


Miranda & Irmão, Lda.



Telef. 622600 / 622449 Telex 37047 MILBON P

Telefax (034) 601736 Apart. 45 3751 ÁGUEDA

PORTUGAL

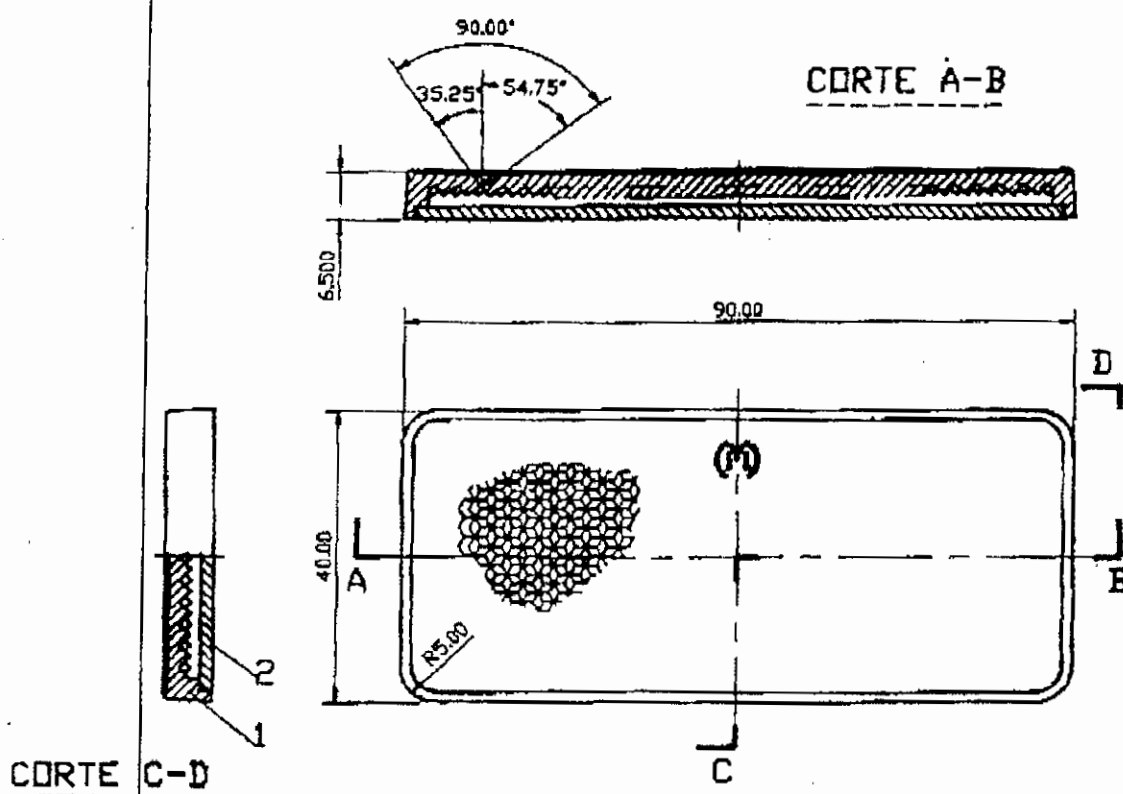

LABORATÓRIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTÉCNICA E. T. S. L. I.
DOCUMENTACIÓN ANEJA AL
INFORME N.º 96/04/34

Art-Bez.: R118

Art-Mr.: 31.0005.501-.521

Todos os direitos de propriedade nos estão reservados.
Proibido copiar ou deixar em poder de terceiros sem nossa permissão escrita.

Nr.	Quant	Designação	Material	Nr. Norma
2	1	BASE	ABS	
1	1	VIDRO	ACRILICO	
Escala:				
Nr. Desenho:			Data: 92.02.25	Des. J. Gonçalves
				Verif.

31.0005.501-521

**CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE UN TIPO DE DISPOSITIVO
CATADIOPTRICO /**

Certificat d'homologation d'un type de dispositif catadioptre

Reglamento nº 3 ECE

Nº de homologación: IA*E9*02.4006

1. Marca de fábrica o de comercio / Marque de fabrique ou de commerce: MIL 450072/4/6
2. Clase / Classe: IA ROJO / AMARILLO AUTO / BLANCO
3. Nombre del fabricante/ Nom du fabricant: MIRANDA IRMAO LDA.
4. Dirección / Adresse: 3751- AGUEDA, APTO. 45- BORRALHA (PORTUGAL)
5. Eventualmente nombre de un representante / Le cas échéant, nom d'un représentant: - -
6. Dirección / Adresse: - -
7. Presentado a homologación el/ Présenté pour l'homologation le: octubre /96
8. Laboratorio de ensayos: L.C.O.E.
9. Fecha y número del certificado del laboratorio/ Date et numéro du certificat du laboratoire:
15-10-96/ 96104134
10. Fecha de homologación/ Date d'homologation: 17-10-96
11. Fecha de extensión de homologación/ Date d'extension d'homologation: - -
12. Fecha de las deducciones/ Date des procès-verbaux du laboratoire: - -
13. Laboratorio de ensayos / laboratoire des essais: - -
14. Fecha y números del certificado del laboratorio: - -
15. Fecha de retirada/ Date du retrait: - -
16. Observaciones / Remarques:

"EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL"



D. Antonio Muñoz Muñoz
Resolución P.D. 03-09-96

